 <b>Wagi Wielkopolska</b>	<b>Zasada podejmowania decyzji</b>	Wydanie: 01 Data: 20.07.2023.
		Strona 1 /3
<b>PN - EN ISO / IEC 17025 : 2018 - 02</b>		<b>F-01/IP – 01</b>

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD PODEJMOWANIA DECYZJI

W przypadku gdy zlecający (klient) oczekuje zamieszczenia w świadectwie stwierdzenia zgodności dokonuje się z nim uzgodnień dotyczących

- specyfikacji, kryteriów do których należy się odnieść
- zasady podejmowania decyzji (patrz niżej)

### **A. Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności proponowana przez laboratorium:**

#### **1. zasada prostej akceptacji \***

**akceptacja** - wymaganie spełnione (wynik zgodny) jeśli wartość zmierzona znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej – ryzyko błędnej akceptacji może sięgać 50 % gdy wynik jest zbliżony do wartości dopuszczalnej (blisko granicy tolerancji)

**odrzućenie** – wymagania niespełnione (wynik niezgodny) jeśli wartość zmierzona znajduje się powyżej granicy wartości dopuszczalnej - ryzyko błędnego odrzucenia do 50% może sięgać 50 % gdy wynik jest zbliżony do wartości dopuszczalnej (blisko granicy tolerancji)


#### **2. zasada pasma ochronnego \* (pasma ochronne stanowi niepewność rozszerzona $U_{95}$ )**

**akceptacja** –wynik pomiaru jest zgodny, jeśli znajduje się w strefie akceptacji - ryzyko błędnej akceptacji do 2,5%


**odrzućenie** - wynik pomiaru jest niezgodny jeśli znajduje się w strefie odrzucenia - ryzyko błędnego odrzucenia do 2,5%

**warunkowa akceptacja** - wynik pomiaru mieści się w polu tolerancji w paśmie ochronnym  $U_{95}$ , jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru przekracza granicę tolerancji) - ryzyko błędnej akceptacji do 50%


**warunkowe odrzućenie** - wynik pomiaru mieści się w poza granicami tolerancji, jednak rozszerzona niepewność wyniku pomiaru znajduje się w paśmie ochronnym - ryzyko błędnego odrzucenia do 50%


 <p><b>Wagi Wielkopolska</b></p>	<p><b>Zasada podejmowania decyzji</b></p>	Wydanie: 01
		Data: 20.07.2023.
<p><b>PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</b></p>		Strona 2 /3
		<b>F-01/IP – 01</b>

### Stwierdzenie zgodności

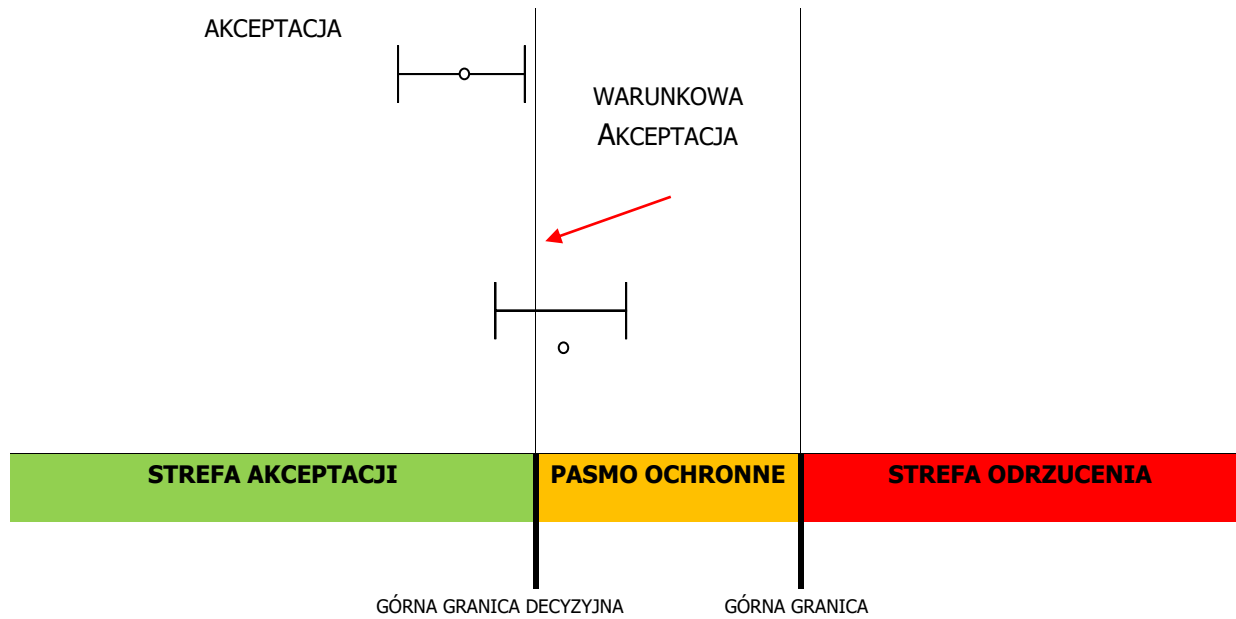

### Stwierdzenie niezgodności

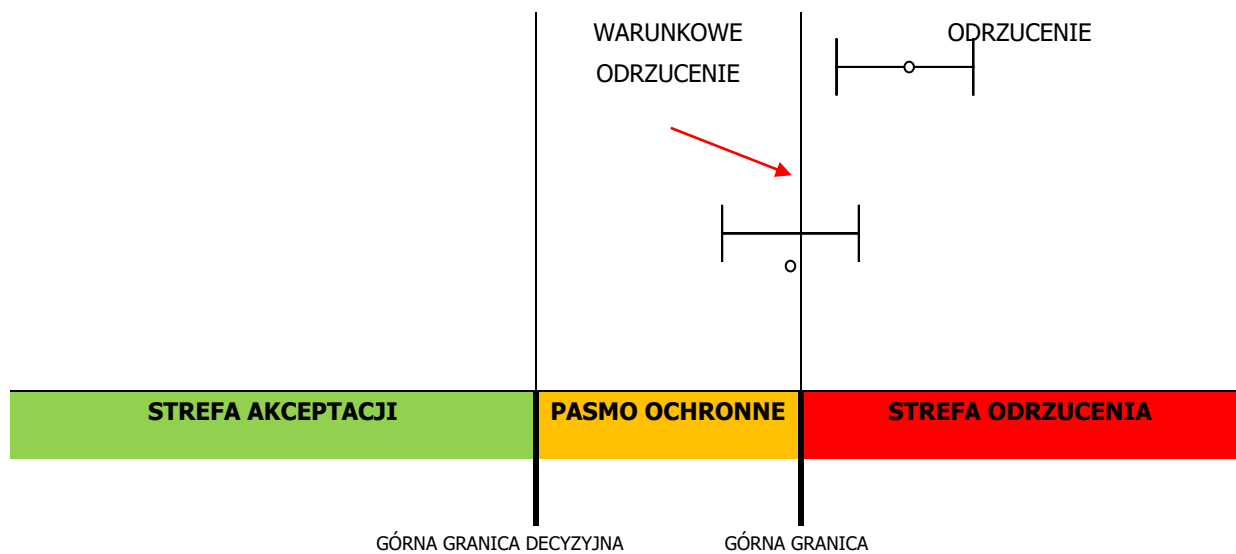

	<b>Zasada podejmowania decyzji</b>	Wydanie: 01 Data: 20.07.2023.
		Strona 3 /3
	<b>PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</b>	<b>F-01/IP – 01</b>

### **B. Zasada wskazana przez klienta**

W przypadku gdy klient sam wskazuje zasadę podejmowania decyzji np. bez uwzględniania niepewności, w sprawozdaniu nie przeprowadza się dyskusji na temat ryzyka błędnego uznania wyników za zgodne bądź niezgodne z wymaganiami.

Literatura:

1. ILAC – G8-09/2019